NOTICE D'UTILISATION DES BALANCES ELECTRONIQUES

RÉFÉRENCE N3670 - 6 kg
RÉFÉRENCE N3671 - 12 kg
RÉFÉRENCE N3672 - 30 kg
RÉFÉRENCE N3673 - 50 kg

Merci de lire ce mode d'emploi avant toute utilisation
afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute sécurité.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL À LA PORTÉE DES ENFANTS.
UTILISER L'APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE, STABLE ET DEGAGEE.

CARACTÉRISTIQUES

Balance électronique.
Fonctionne avec 4 piles de type R14 taille C 1,5 V.
Fonctionne avec adaptateur secteur de type DC 6 V 100 mA (non fourni).
Dimensions : 30 x 32 x 11,5 cm
Dimensions du plateau inox : 30 x 23,5 cm
Poids net : 3,100 kg

	N3670	N3671	N3672	N3673
Pesage maximum	6 kg	12 kg	30 kg	50 kg
Précision	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Pesage minimum	10 g	20 g	40 g	100 g

MONTAGE

Positionner la balance sur une surface plane et stable.
Ajuster les pieds de la balance afin que le niveau de la bulle, situé à gauche, soit centré.
Installer le plateau sur la balance (les pieds du plateau doivent s'insérer dans les logement prévus à cet effet).
Insérer les 4 piles dans leur logement situé sous l'appareil.
L'appareil est prêt à être utilisé.

DESCRIPTIF DE L'ÉCRAN - DU PANNEAU DE CONTRÔLE

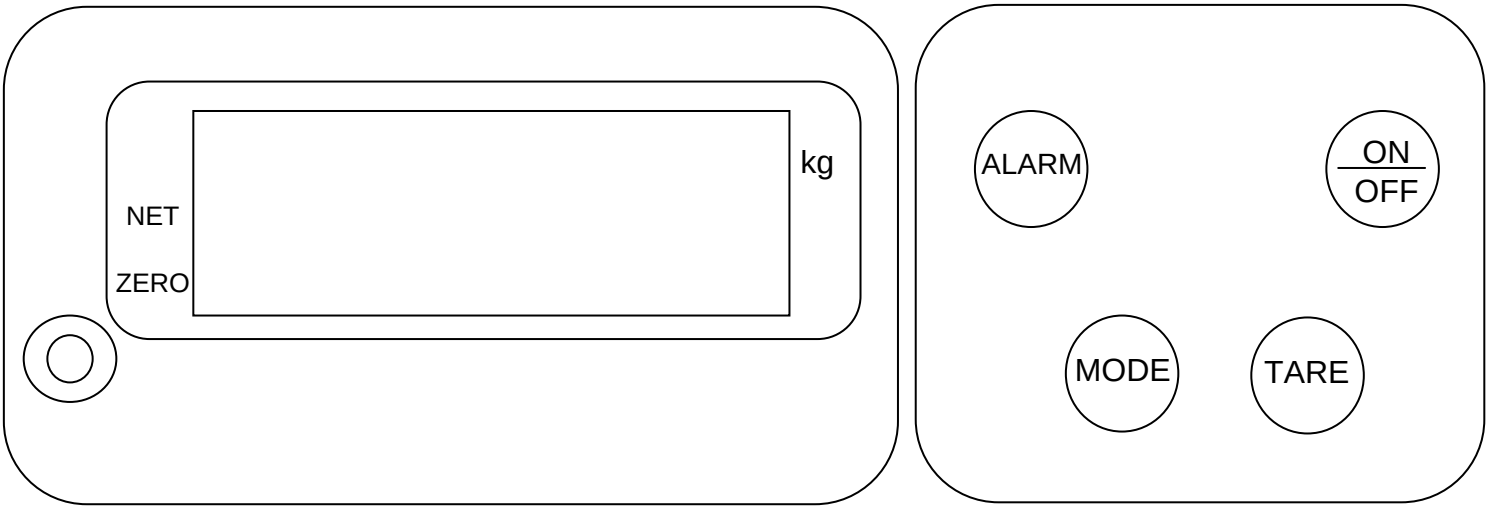

UTILISATION

Allumer la balance en appuyant sur le bouton ON/OFF.
Lorsque "0.000" apparaît à l'écran, le curseur " ▶ " clignote face à **kg**, un rond " ◯ " se positionne face à ZERO et l'appareil est prêt à être utilisé.

PESAGE

Appuyer sur la touche "MODE" afin de sélectionner l'unité de mesure souhaitée (kg/oz).
Le curseur " ▶ " clignote et se positionne devant l'unité de mesure choisie
Poser le ou les articles à peser sur le plateau, l'écran affiche le poids.

TARE

La tare permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un bac lors de la pesée.
Poser le récipient vide sur le plateau, le poids du récipient s'affiche.
Appuyer sur la touche "TARE", l'écran affiche alors "0.000".
Remplir le récipient des articles à peser, l'écran affiche le poids exact des articles.

ALARME SET

La fonction alarme permet à la balance de mémoriser un certains poids. Lorsque ce poids est atteint par la balance, un bip retentit.
Allumer la balance.
Poser sur la balance le poids référence.
Appuyer sur la touche "ALARM ", des bips retentissent.
A l'écran s'affiche "AL - on" puis le poids référence clignote sur l'écran.
Retirer le poids de la balance.
Le poids est alors mémoriser.
Poser de nouveaux articles sur la balance, une fois que le poids enregistré est atteint, une série de bips retentit.
Pour désactiver cette fonction appuyer sur la touche "ALARM", l'écran affiche "AL - of" signalant la fin de la mémorisation du poids référence.

TEMOIN D'USURE DES PILES

Lorsque le niveau de la batterie devient insuffisant, l'écran affiche " Lo ".
La balance s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inutilisation.

CALIBRAGE

1) La balance éteinte, appuyer, sans la relâcher, sur la touche **TARE** jusqu'à ce que l'écran affiche une valeur.
2) Appuyer de nouveau sur la touche **TARE** , l'écran affiche « **2Ero »**, puis il affiche à nouveau une valeur.
3) Selon la valeur affichée (par exemple 5000), déposer la même valeur (soit 5 kilos) sur le plateau.
4) Appuyer sur **TARE**, après deux secondes l'écran affiche **« CAL »** puis **« PASS »**.
5) Retirer le poids déposé au préalable sur le plateau puis éteindre la balance. Le calibrage est effectué.
Remarque : procéder régulièrement à un calibrage de votre balance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge légèrement humide.

UTILISATION INTERDITE POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les réparations nécessaires par suite :
- d'une utilisation non prévue ou d'un emploi abusif de l'appareil
- d'une détérioration par choc ou chute
- d'un montage ou d'un démontage non prévu dans la notice

La garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien régulier.

Participons à la protection de l'environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.